


ЭЭ070'57Э'ЛНИ

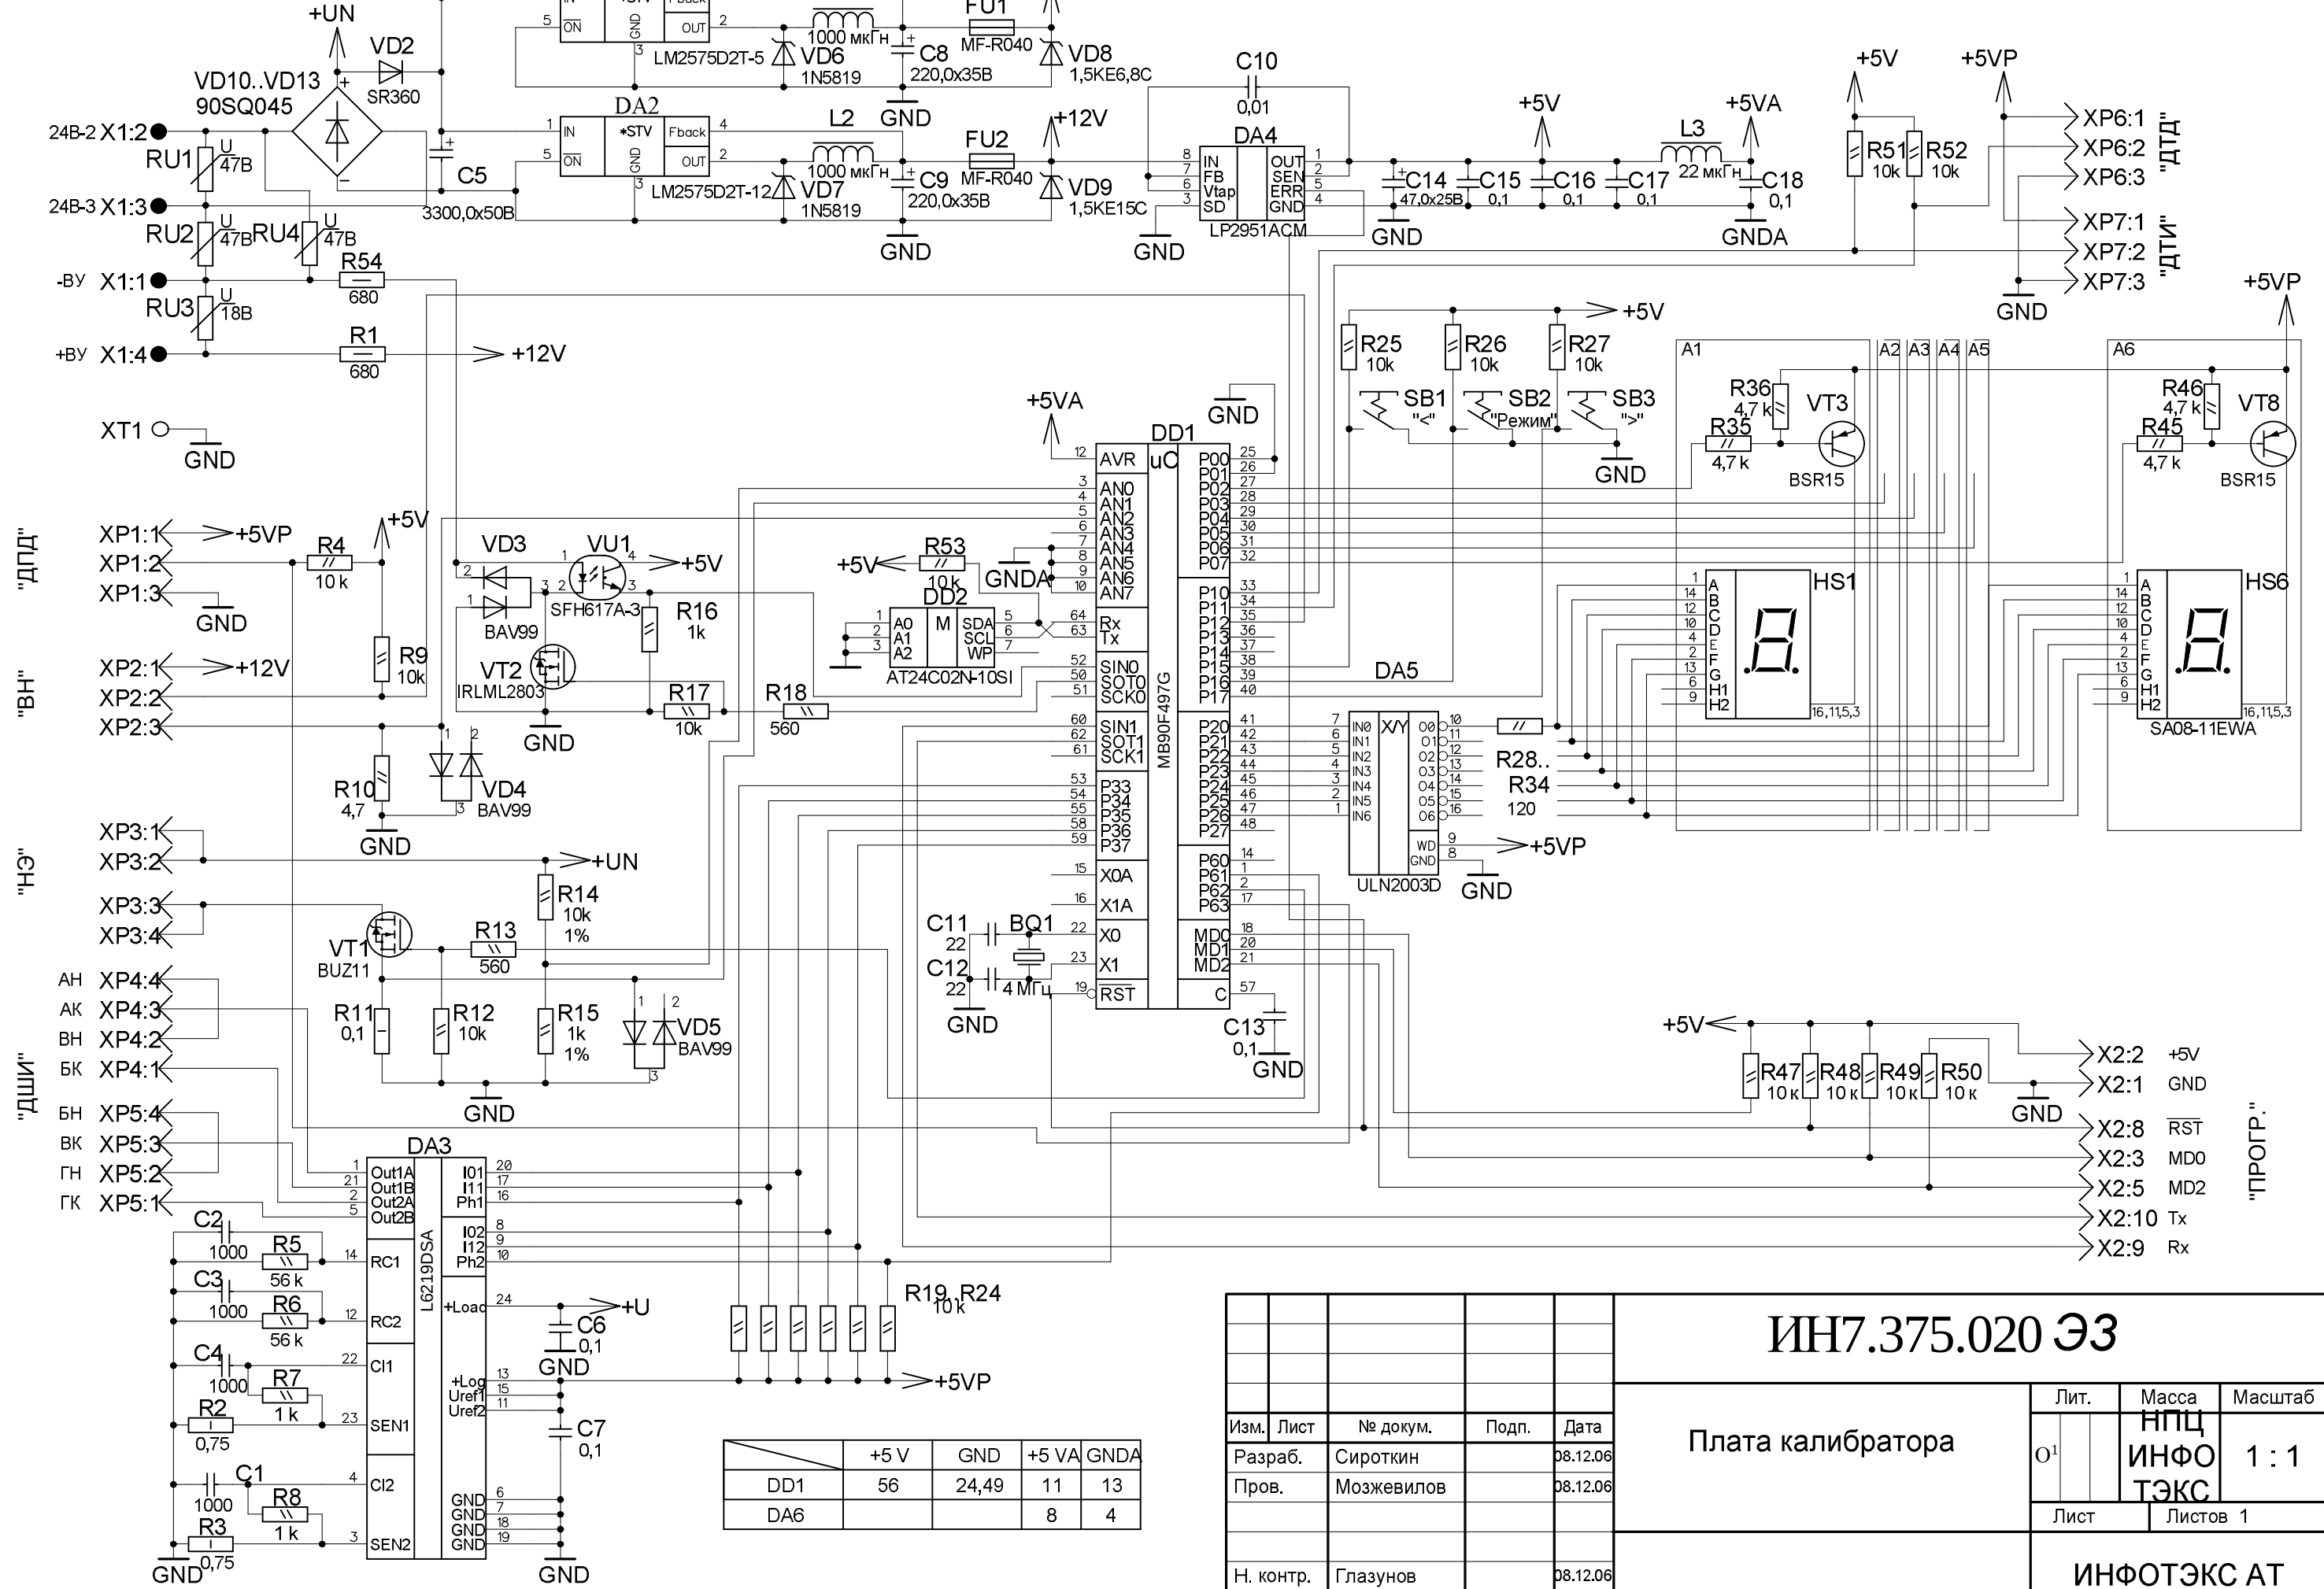

	+5 V	GND	+5 VA	GNDA
DD1	56	24,49	11	13
DA6			8	4

ИН7.375.020 ЭЗ

Плата калибратора

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Разраб. Сироткин 08.12.06

Пров. Мозжевилов 08.12.06

Н. контр. Глазунов 08.12.06

Утв. Анисимов 08.12.06

Лит. Масса Масштаб

О1 ИПО ИНФО ТЭКС 1 : 1

Лист Листов 1

ИНФОТЭКС АТ

Копировал Формат А3